

デジタルストレッチャー用スケール



No. _____

Seca
スリッパ-スタイル
Seca 657

№10000000451422

Seca 472
テラスプレイスタイル



No. _____



No. _____

4 3 2 1 2 16 3 1

シングルユースビデオ軟性気管支鏡

No. _____



Ambu
a Scope 4
ゴロコスリ
476001000
ゴロコラビラー
477001000
ゴロコラージ
478001000

No. _____



Ambu E-7
405002000
S/N AM20600090

No. _____



1 * 1 6 2 1 * 1 6

血液ガス分析装置



No. _____



No. _____




No. _____

血液ガス分析装置2

No. _____



No. _____

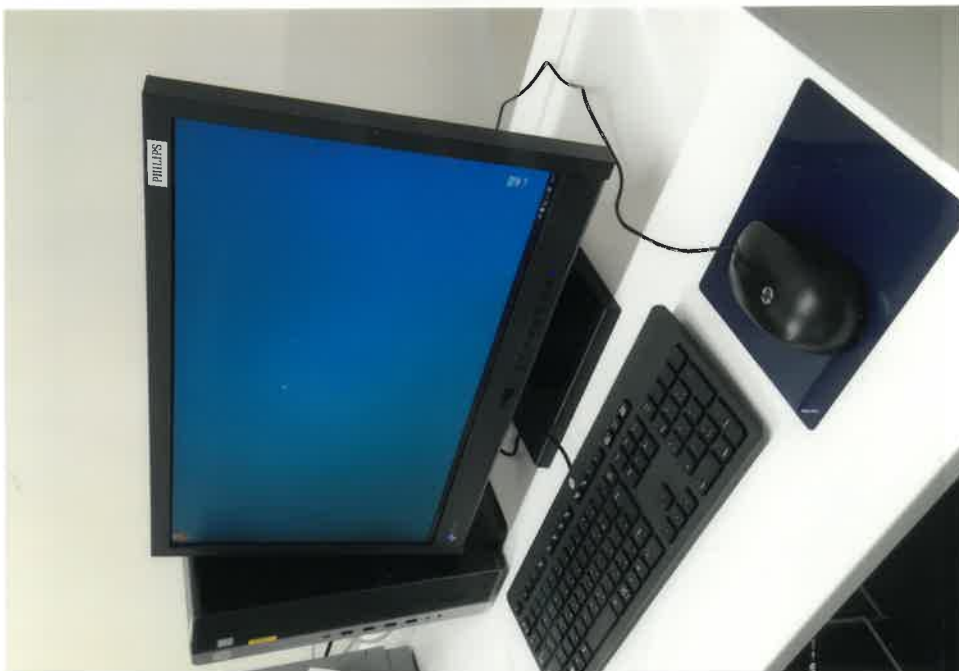

No. _____





No. _____

カーリーナシステム
監視ビデオカメラ
VR-X8100

32型ディスプレイ×2
43型ディスプレイ×1



No. _____



No. _____

No. _____

監視カメラ用モニター (カーリーナシステム) 2



No. _____

<余白>



No. _____

<余白>



No. _____



体温調節装置
 サーモガードシステム
 本体 + 消耗品

No. _____



体温調節装置
 サーモガードシステム
 本体 側面

No. _____

承認番号	22400BZ100010000
一般的名称	中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム
販売名	サーモガードシステム
型式	Thermogard XP®
シリアル番号	TGXP12940
使用上の注意	説明書をよく読んでからご使用ください。
機器の種類	高度管理医療機器 / 特定保守医療機器
外国特例承認取得者	ZOLL Circulation, Inc. (米国)
選任製造販売業者	旭化成ソールメディカル株式会社 東京都港区

電源的定格	電源電圧	100 - 120 VAC
機器の分類	交流、直流の別	交流
	電源周波数	50 / 60 Hz
水に対する保護の形式	入力電流	6 A
	電撃に対する保護の形式	クラス1 機器
	電撃に対する保護の程度	B 形装着部 (懸交換用カテテル接続部) BF 形装着部 (温度プローブ接続部)
	水に対する保護の形式	IPX1

体温調節装置
 サーモガードシステム
 シリアル No. TGXP12940



No. _____

152カラム
電動リフトベッド
KA-H7410A x3



No. _____

こちあ結起3D
KE-933HS x3
離床グリップ
KA-H70G x3
手元スイッチ
RC-1850 x3
酸素吸入ホルダー
KC-830C x3




No. _____

IVボード
KC-56 x3
中継台-7il
KE-920C x3
ホバーボード-7il
KF-833LA x3

No. _____

パラマウントベッド2

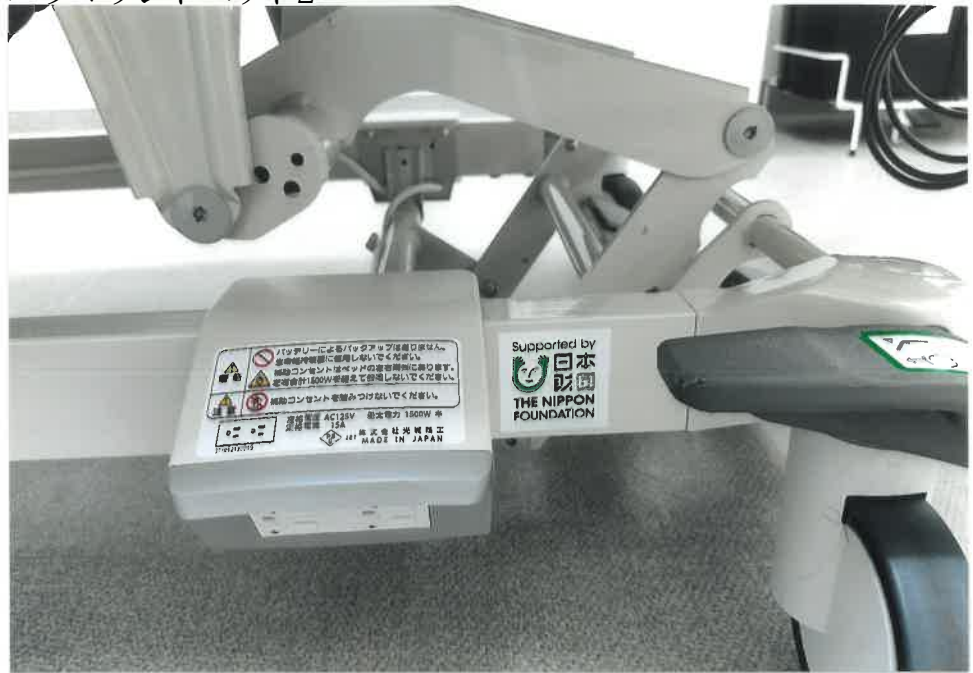

No. _____

〈余白〉



No. _____

〈余白〉





No. _____

No. _____



No. _____



No. _____

No. _____

GE1V27Aジャパン
超音波診断装置

Venue R2.5 本体
医療機器認証番号
229ABBZX00055000
lot. VEB004422




No. _____

インバックス型ロボット
CI-5-RS


リニア型ロボット
L12n-RS

セクタ型ロボット
3Sc-RS

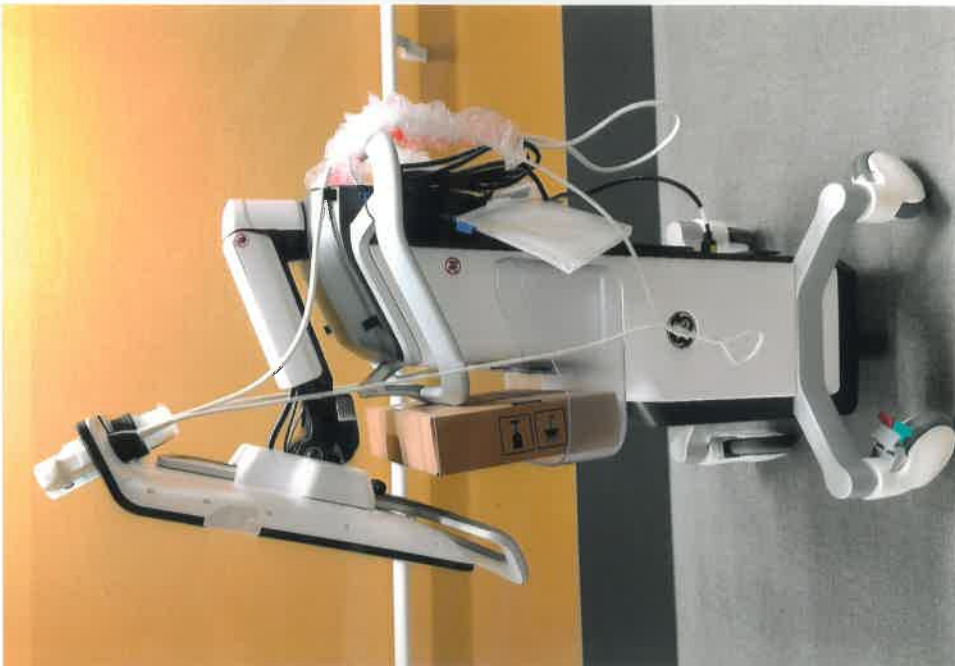

No. _____

SONY白黒テレビカメラ
UP-D711MD

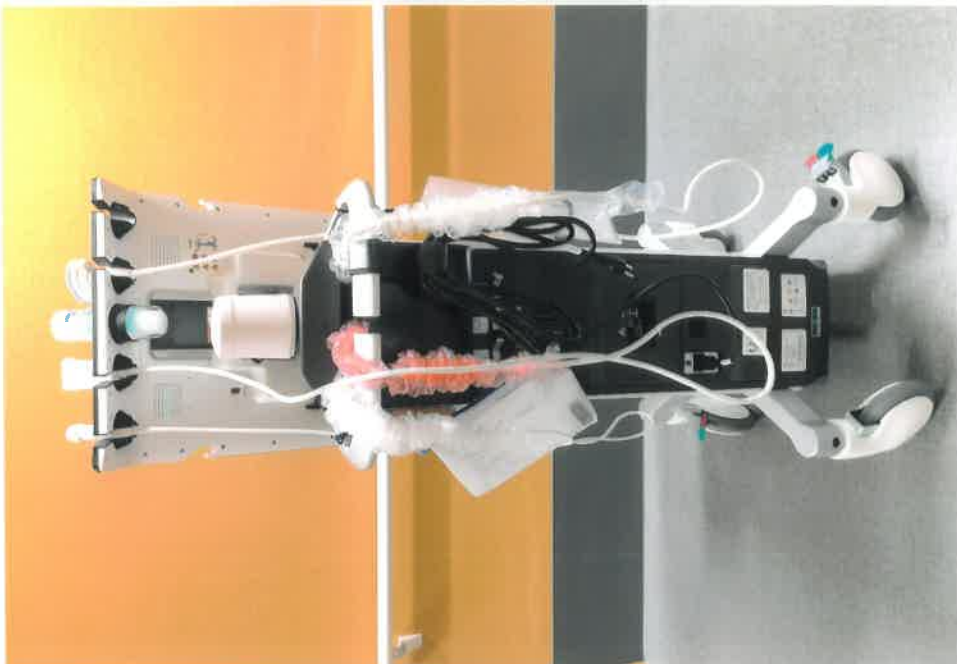

高性能エアマットレス



高性能エアマットレス2



No. _____

No. _____

No. _____



●コードを無理に引っ張らないでください。
 ●リモコン本体に水やその液体をかけたり、濡れた手の操作しないでください。
 ●分解・修理は絶対に行わないでください。
 ●リモコンには運送センサーがついていますが、おとんの中に入れては、電源器具に近づけないでください。
 OSCC
054285

Supported by

THE NIPPON FOUNDATION

△警告
 ●コードを無理に引っ張らないでください。
 ●リモコン本体に水やその液体をかけたり、濡れた手の操作しないでください。
 ●分解・修理は絶対に行わないでください。
 ●リモコンには運送センサーがついていますが、おとんの中に入れては、電源器具に近づけないでください。
 OSCC
054286

Supported by

THE NIPPON FOUNDATION

△警告
 ●コードを無理に引っ張らないでください。
 ●リモコン本体に水やその液体をかけたり、濡れた手の操作しないでください。
 ●分解・修理は絶対に行わないでください。
 ●リモコンには運送センサーがついていますが、おとんの中に入れては、電源器具に近づけないでください。
 OSCC
054290

シングルユースビデオ軟性気管支鏡



No. _____

Ambu
aScope 4
ブロンコスコープ
476001000
lot. 1000421650



No. _____



No. _____

監視カメラ (セコム)



21.5型ワイド液晶モニター

型番：LCD0460

ビデオコンバーター

型番：CNV0170



21.5型ワイド液晶モニター

型番：LCD0460

ビデオコンバーター

型番：CNV0170



高画質NVRドームカメラ

型番：DVC2170